HZY-HL

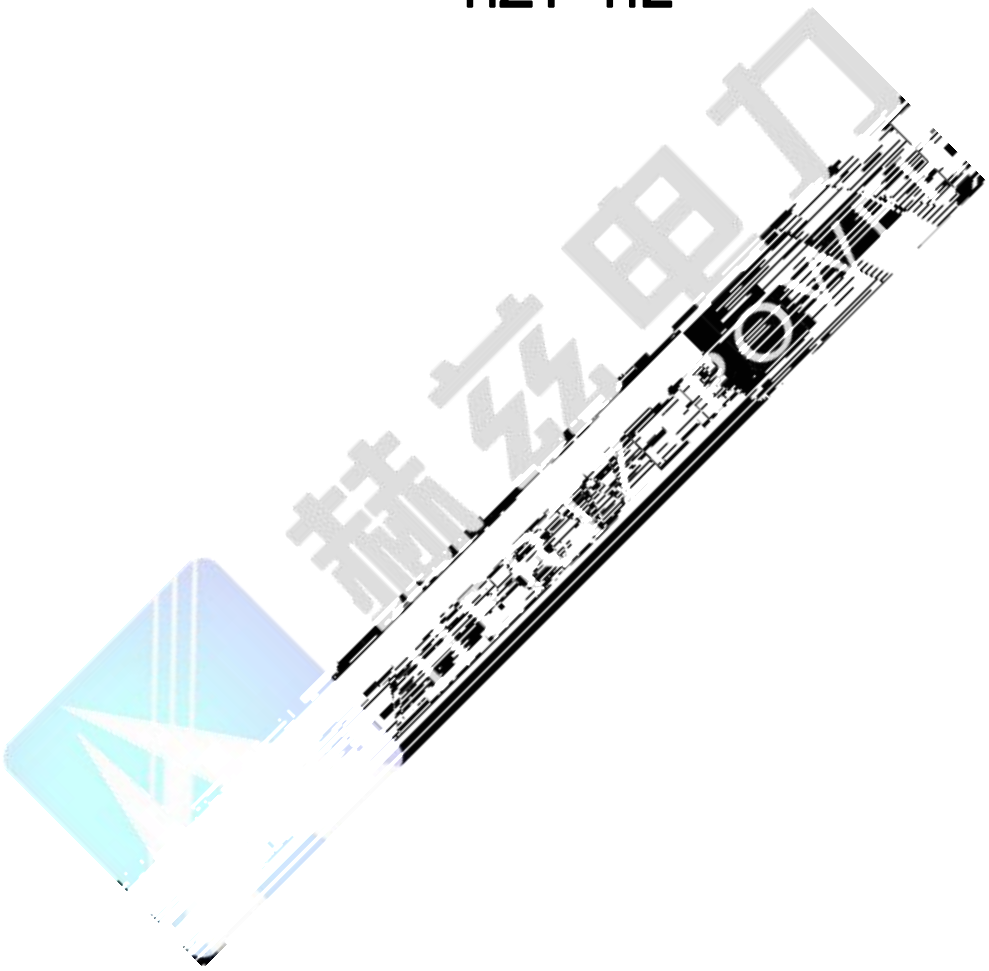

HZY-HL

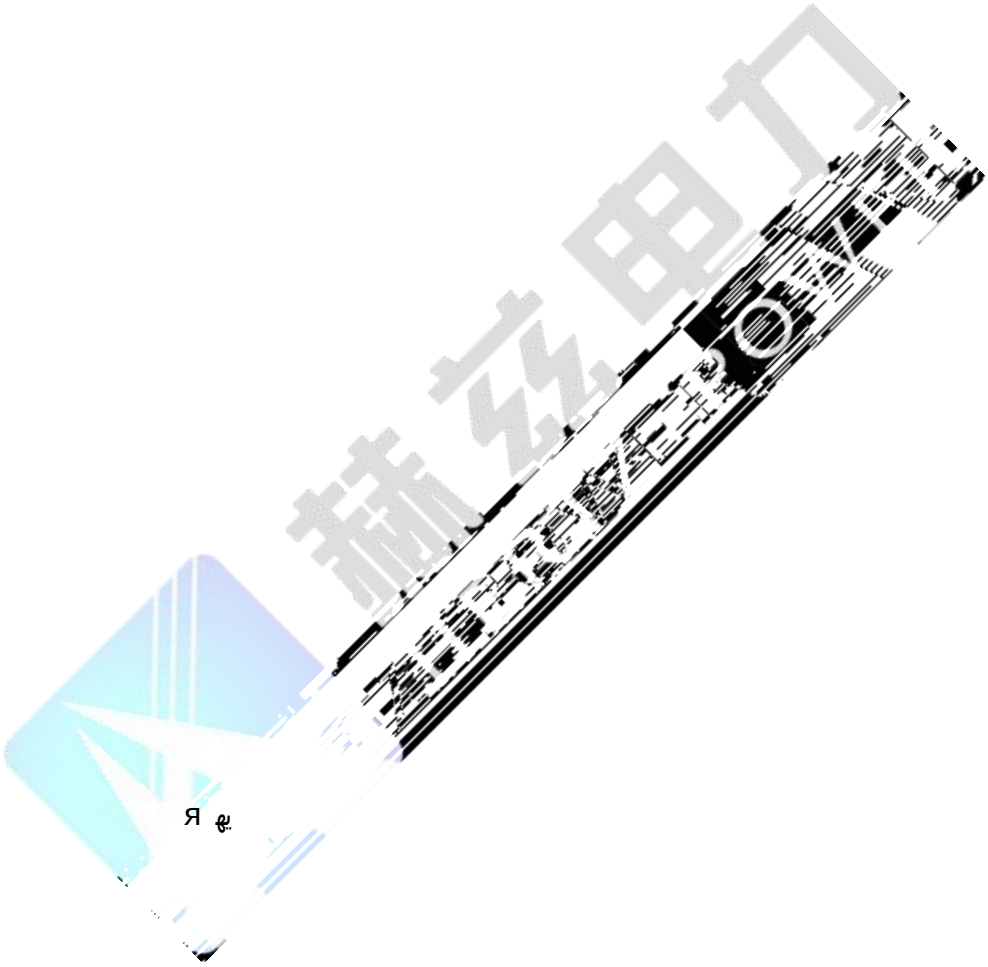

HZY-HL GB/T7599-87

1 8

GB/T7599-87

0.001 1mg KOH/g

≤ ±0.005mg KOH/g

≤0.005mg KOH/g

10 45

≤85%RH

AC220V/50Hz

500W

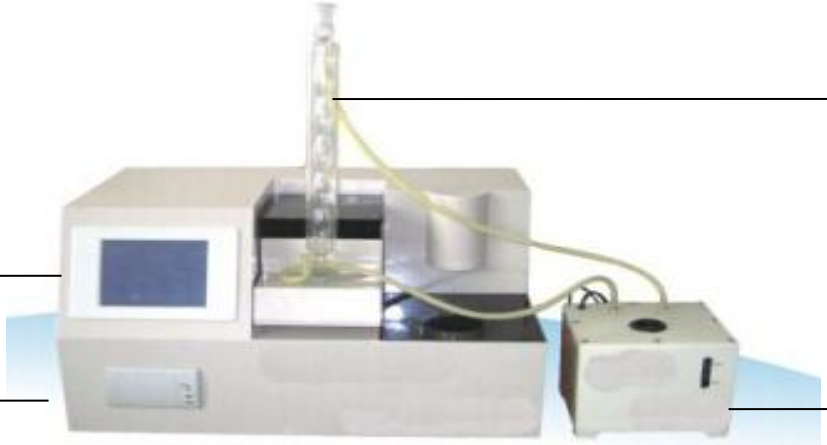

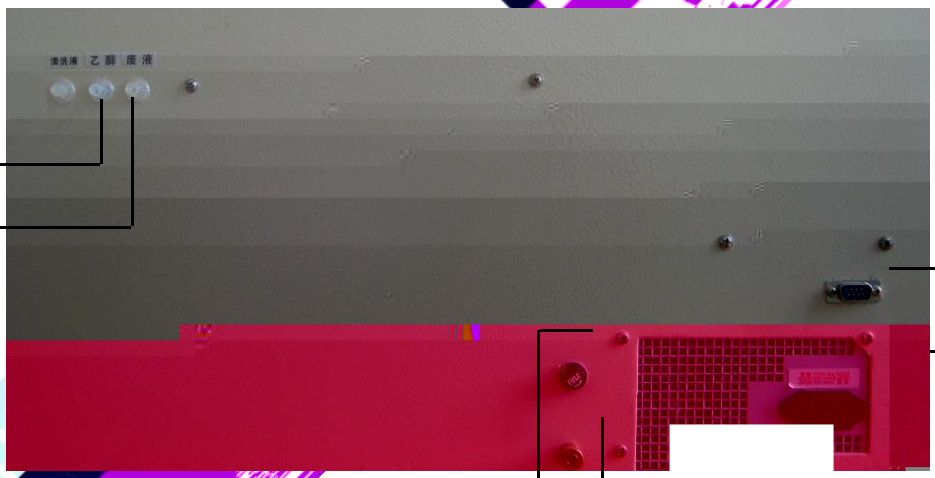

1

2 220V

220V

—KOH BTB (KOH

) BTB

1 :

—KOH 100ml

2 5ml

3 (BTB)

100ml

4 (KOH)

60ml

5 BTB 100ml 1ml

—KOH BTB

—KOH

BTB BTB

—KOH

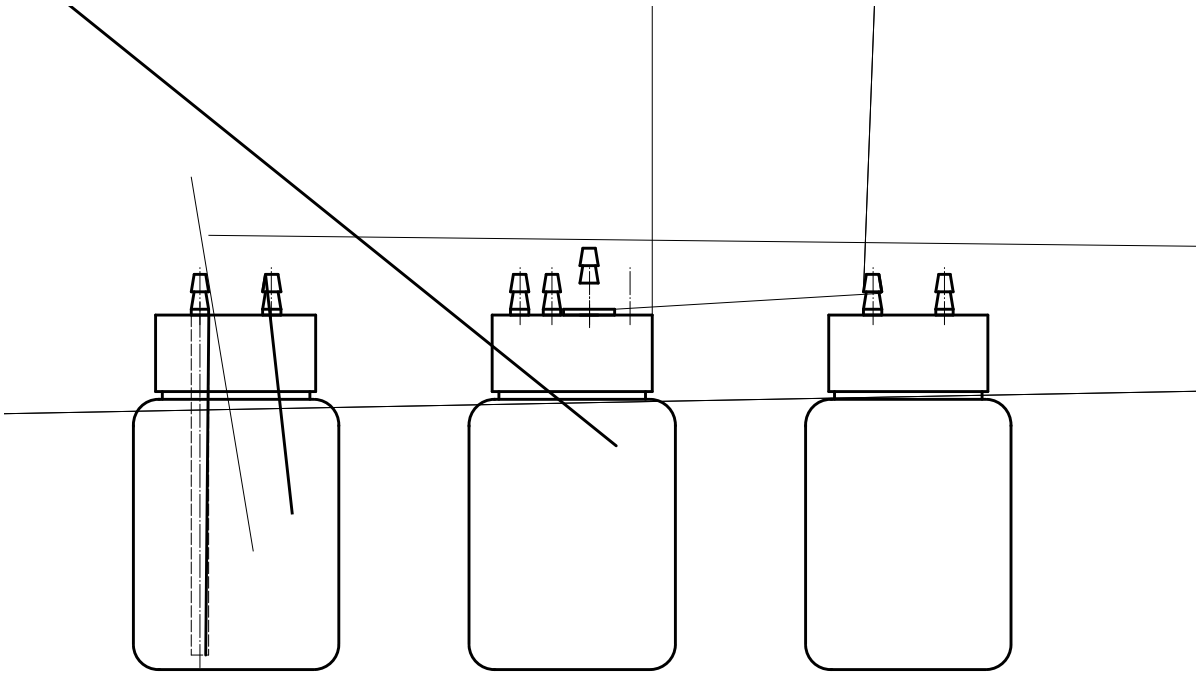

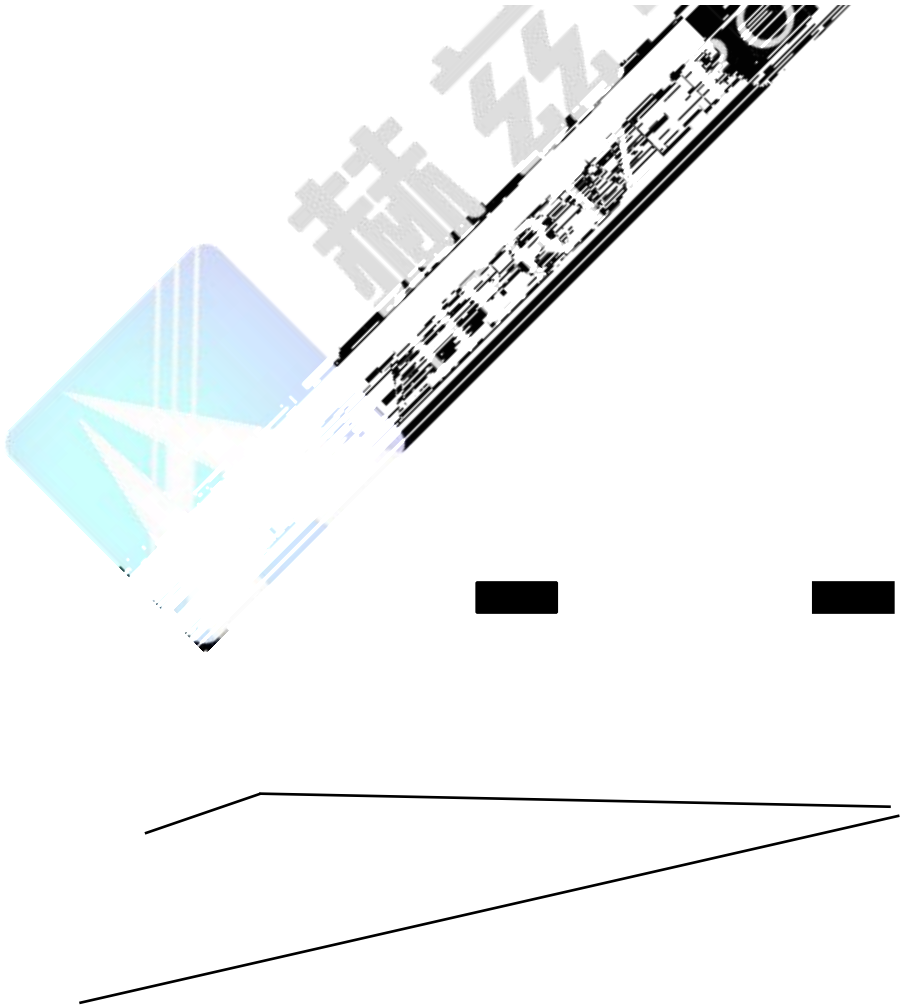

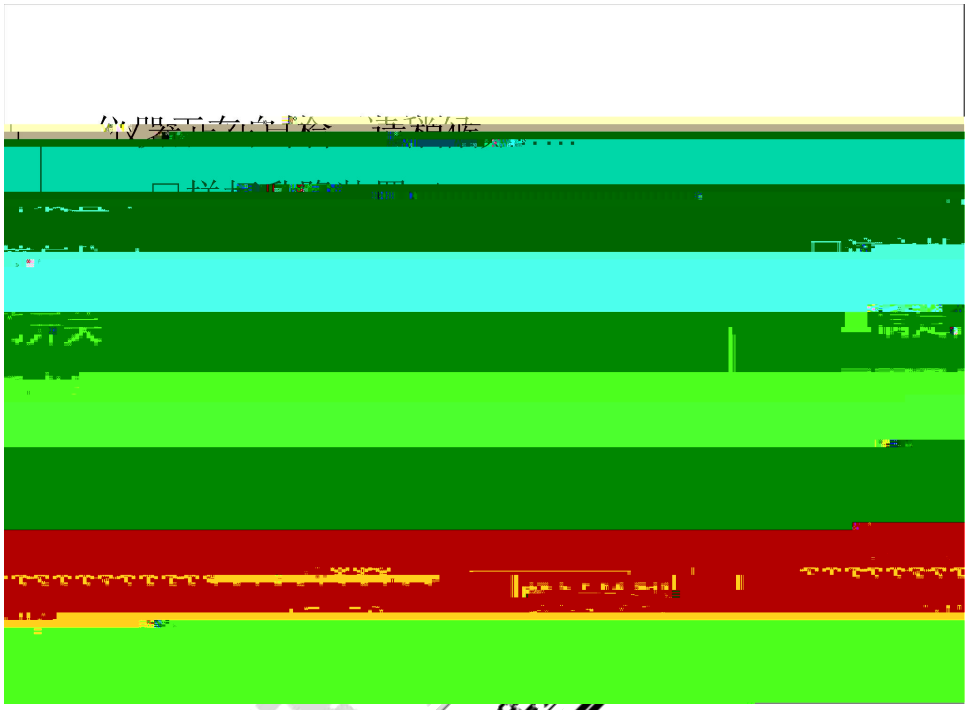

“ ”

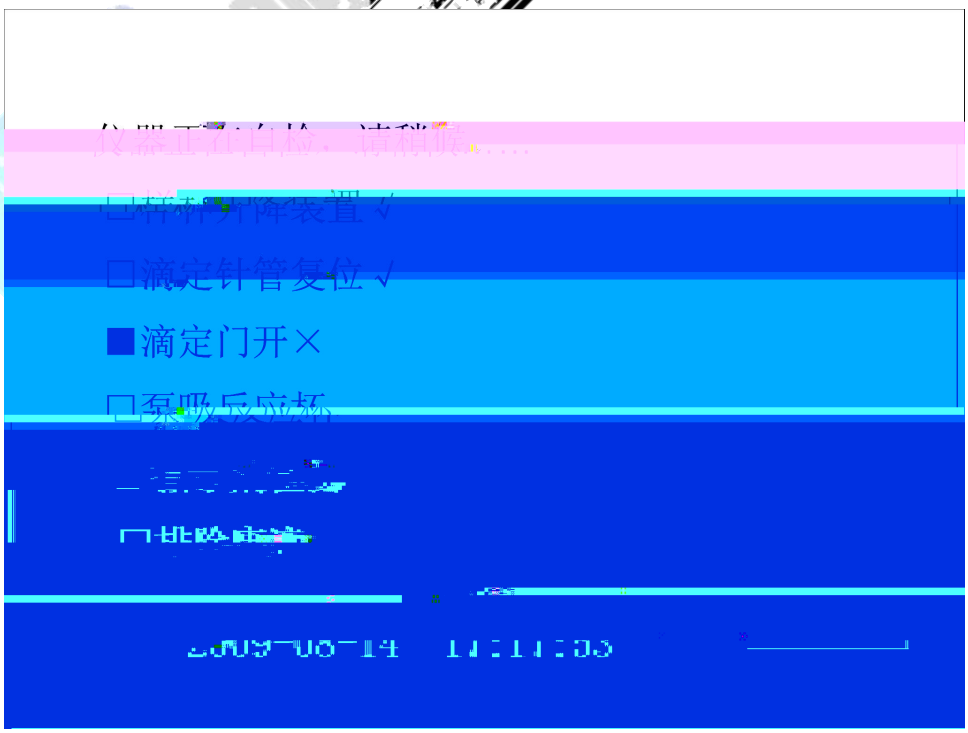
仪器正在自检，请稍候……
□转移升降装置√
□滴定针管复位√
■滴定门开×
□泵吸反应杯
2009-06-14 14:14:53

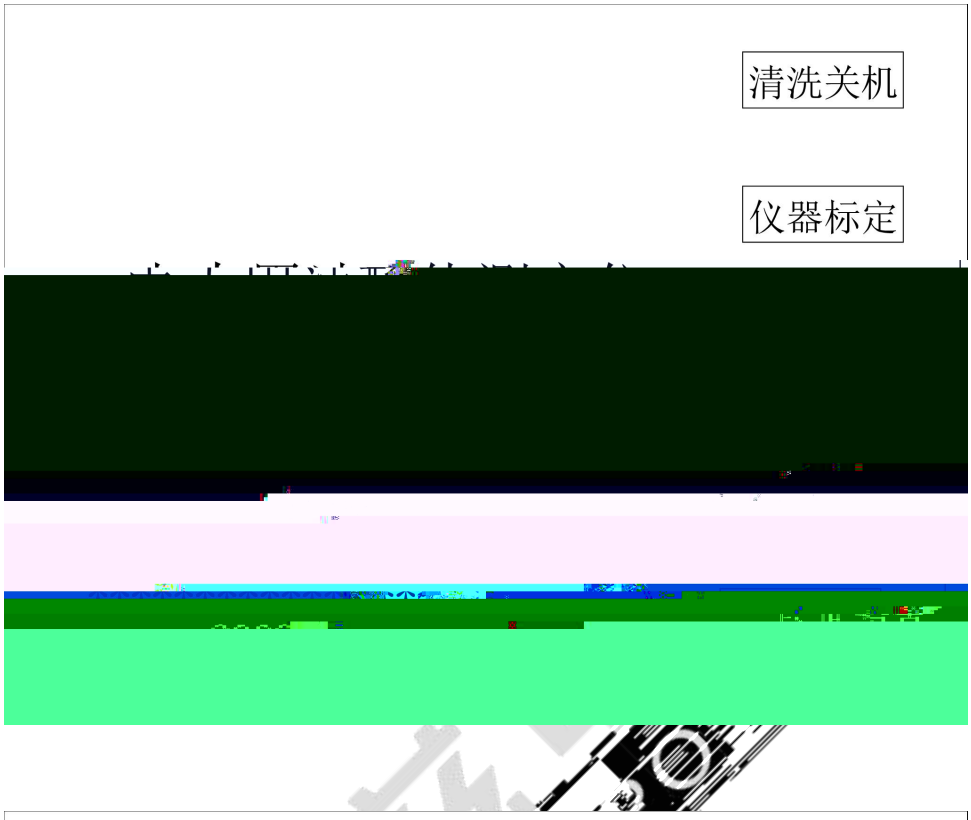
清洗关机
仪器标定

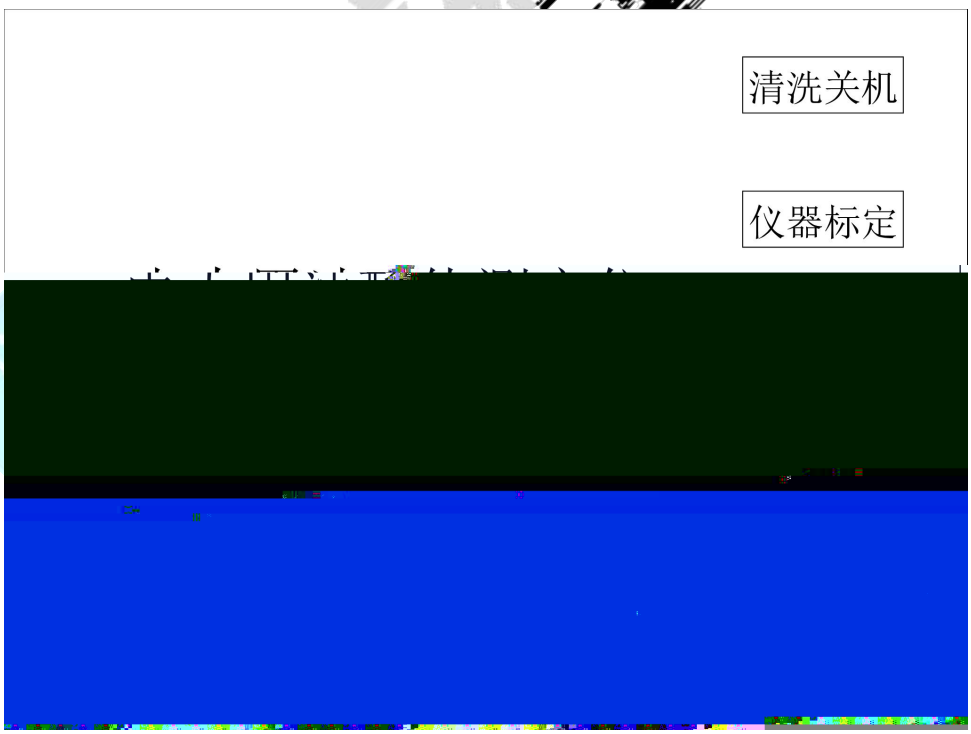
清洗关机
仪器标定

时间设置

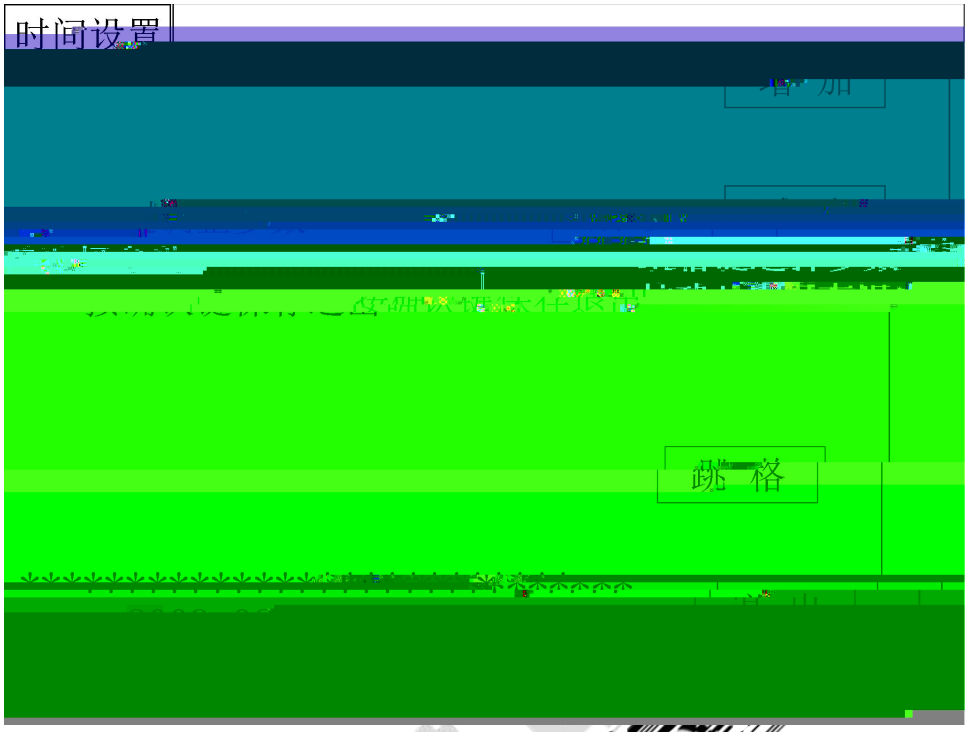

—KOH

“ ”

仪器标定

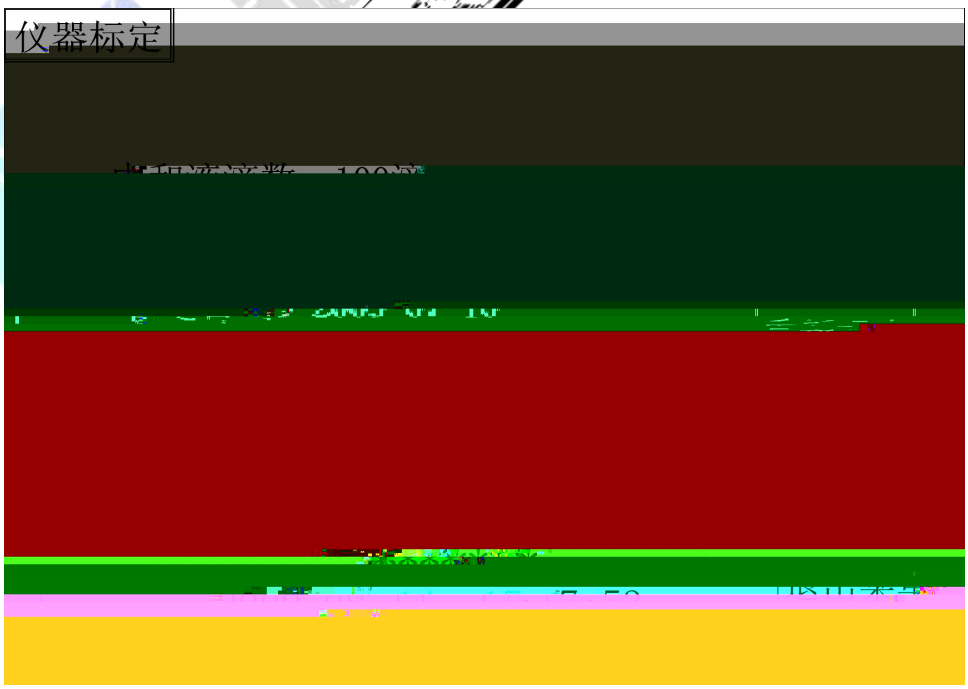

“

”

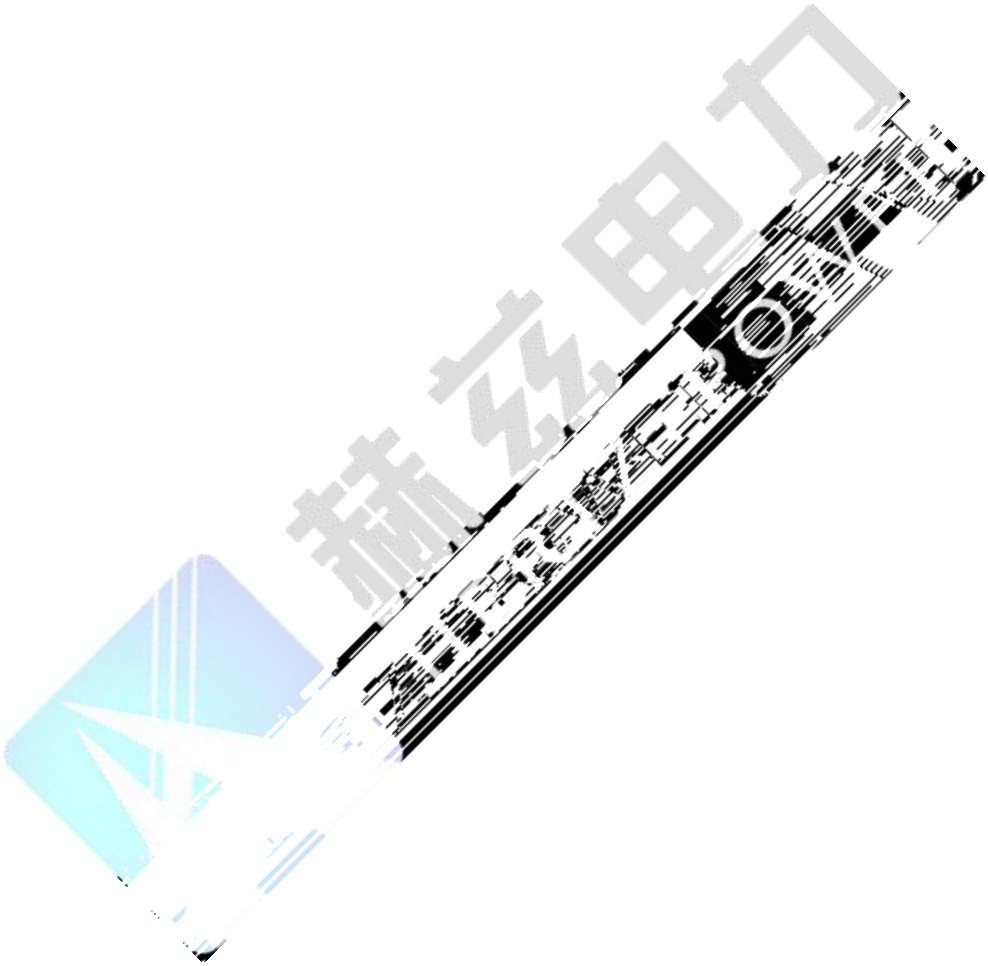

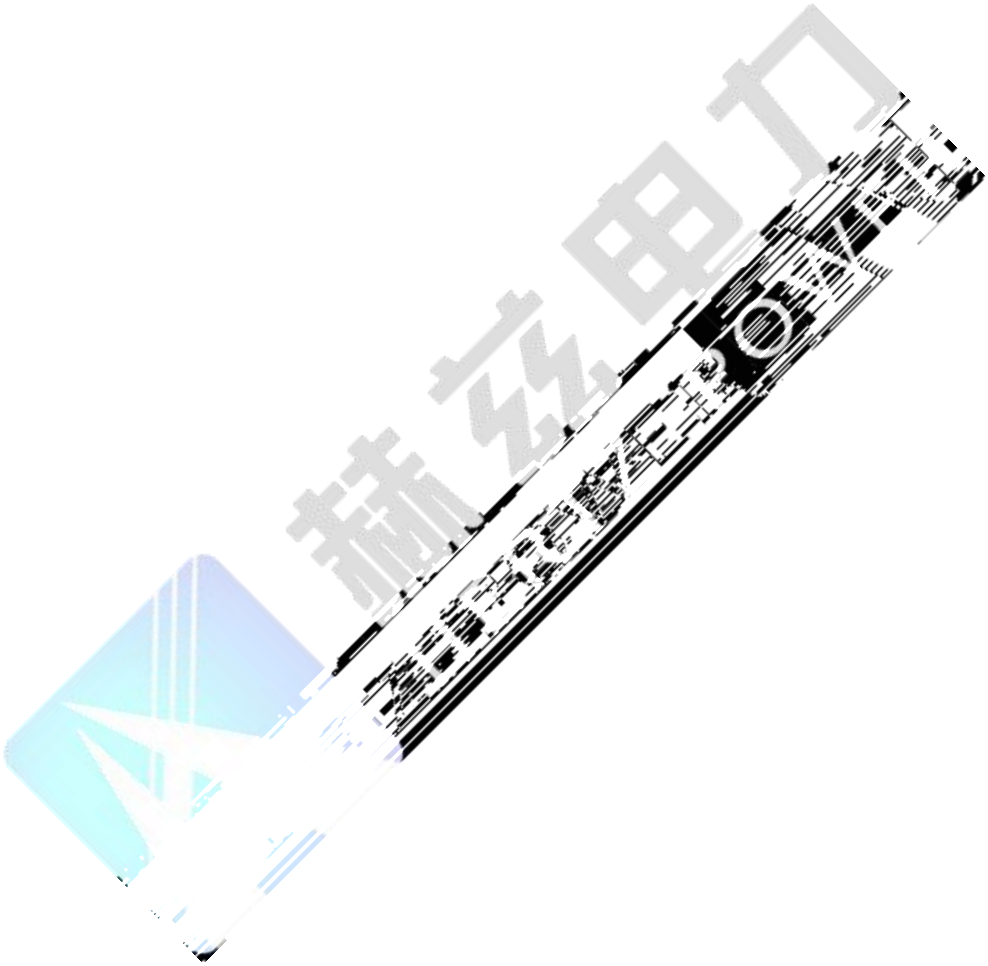

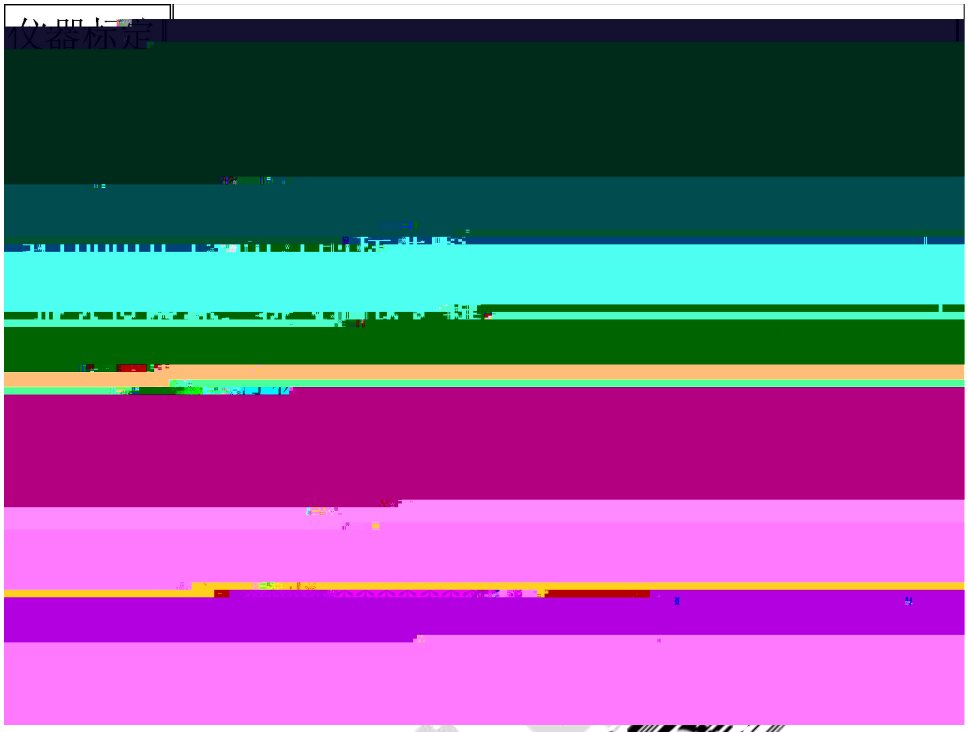

100ul 100ul

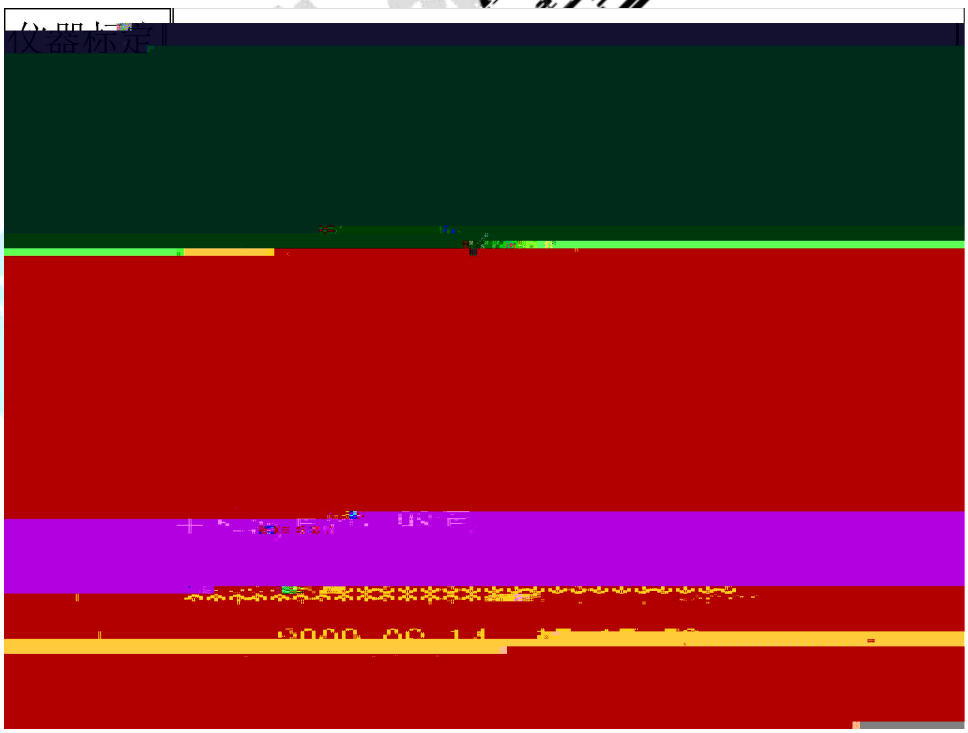

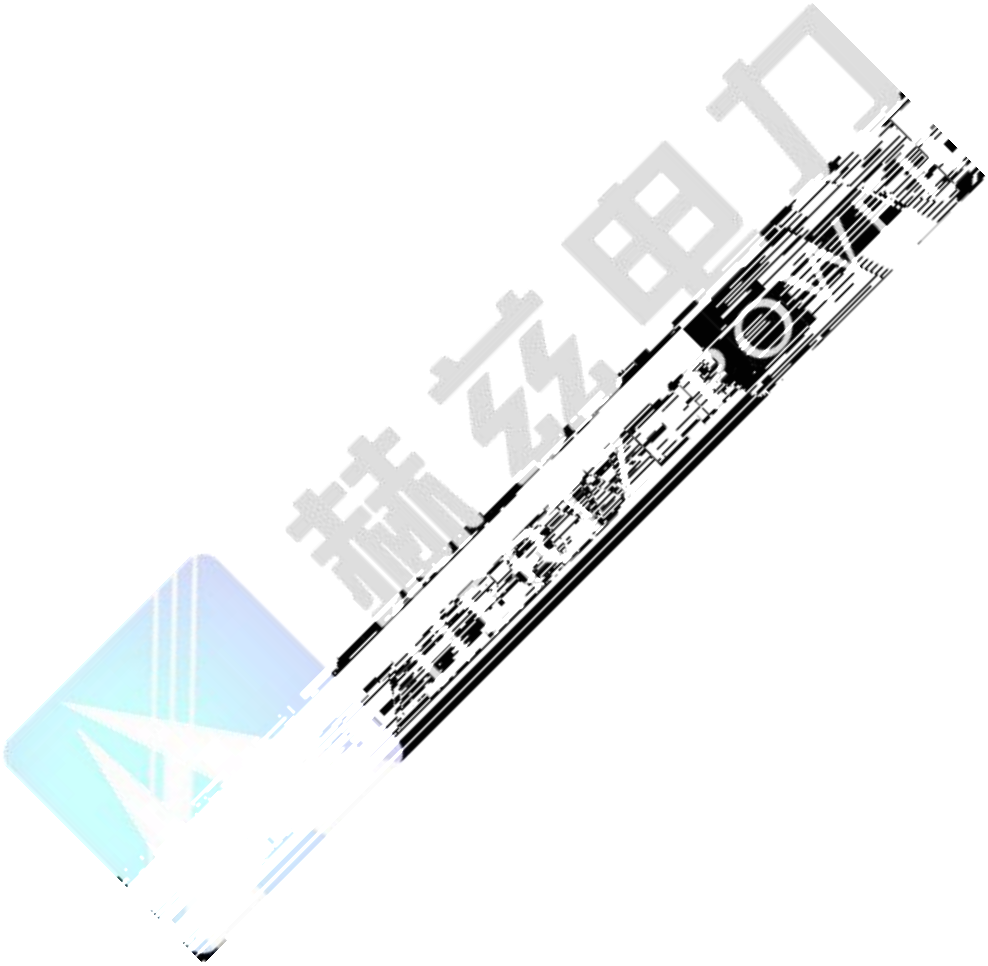

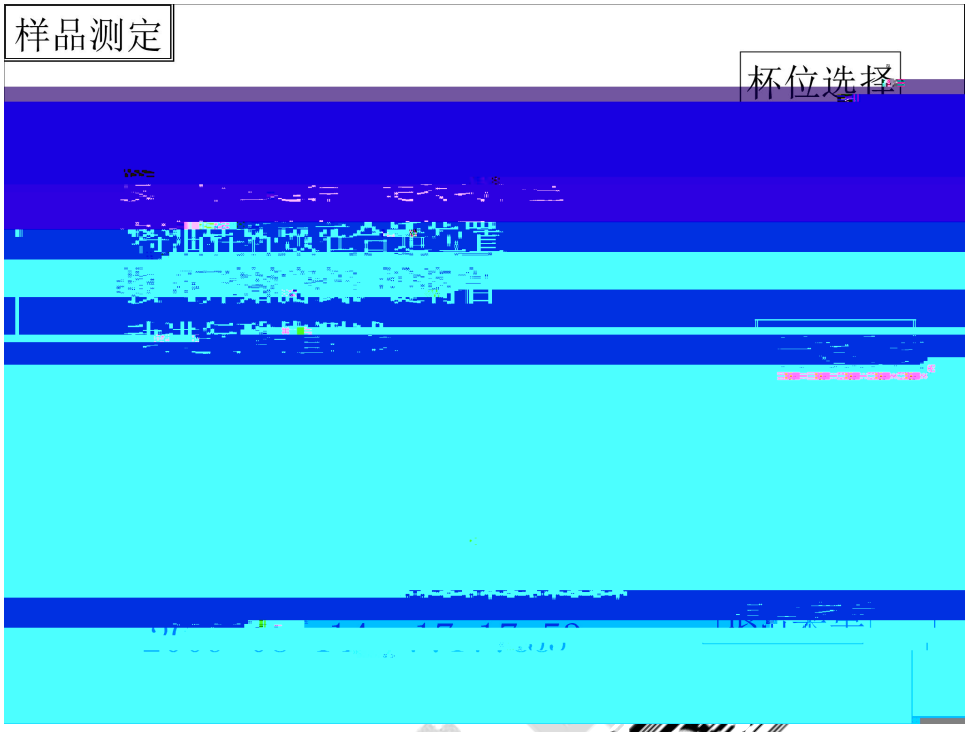

1 8

“ ”

“ ”

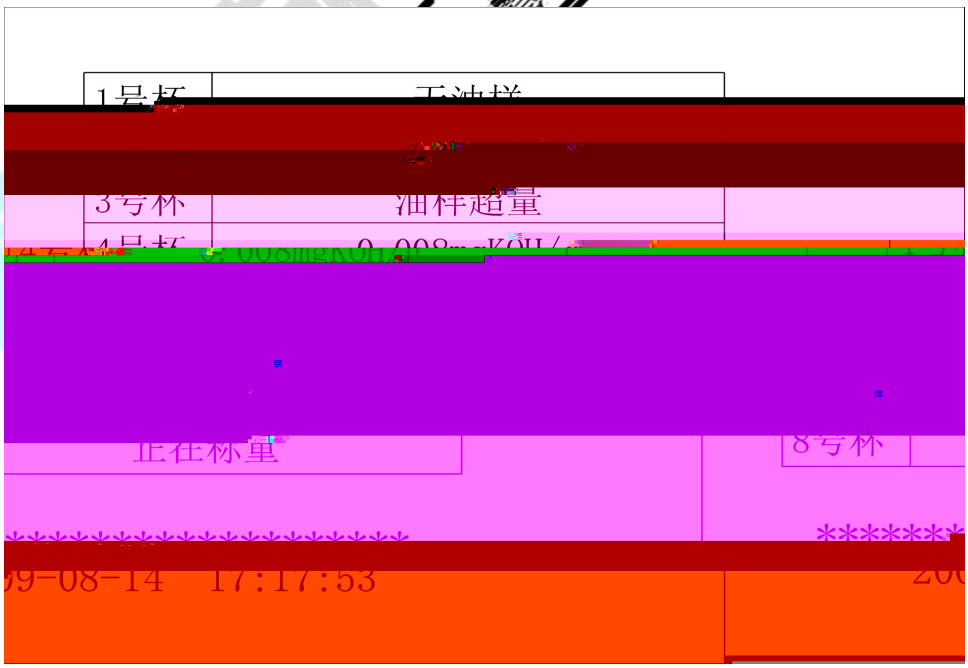

“ ” “ ” “ ”

“ ”

,

1

2

3 80

4 5

5

6

7 5

8

9

1

8

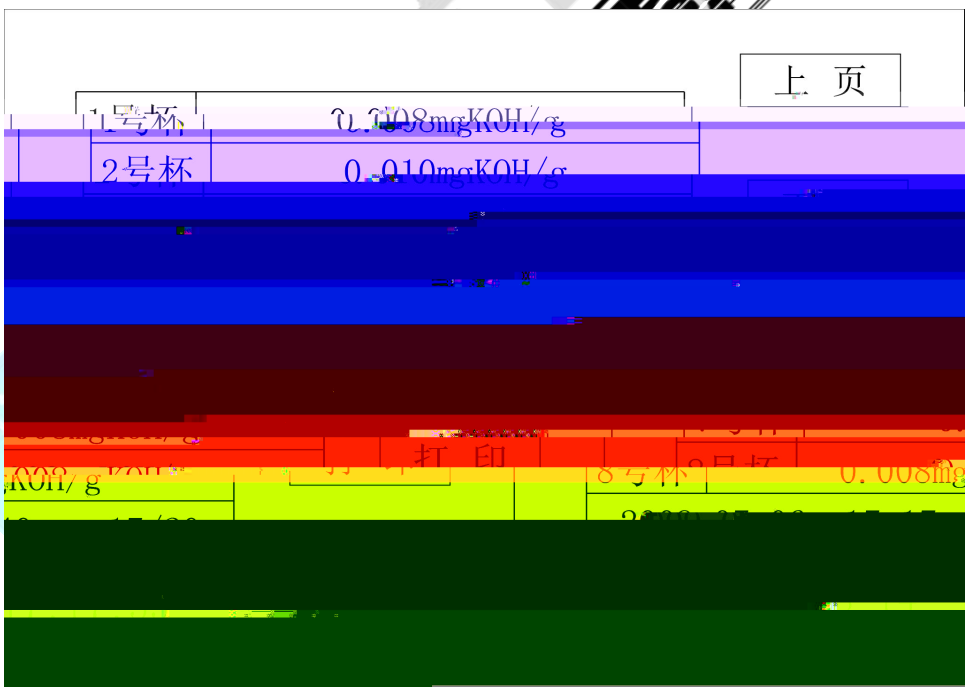

“ ” “ ”

“ ”

8COW.

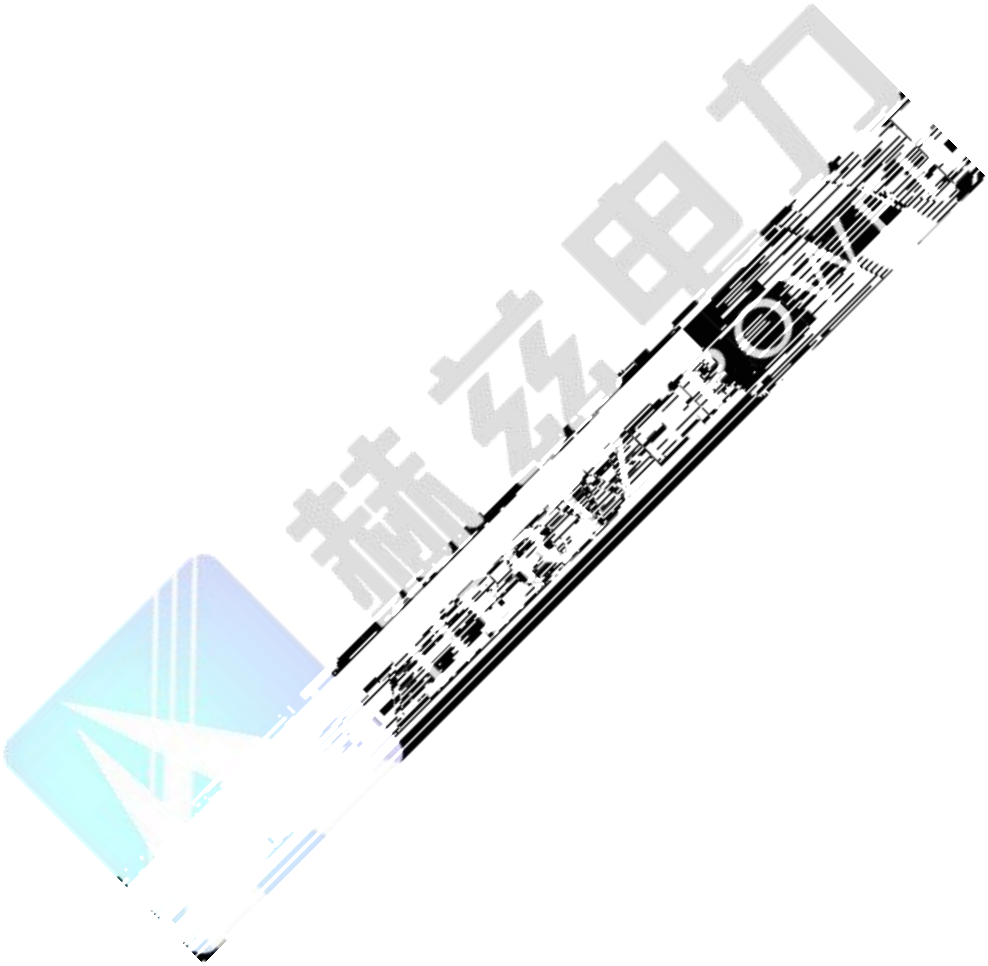

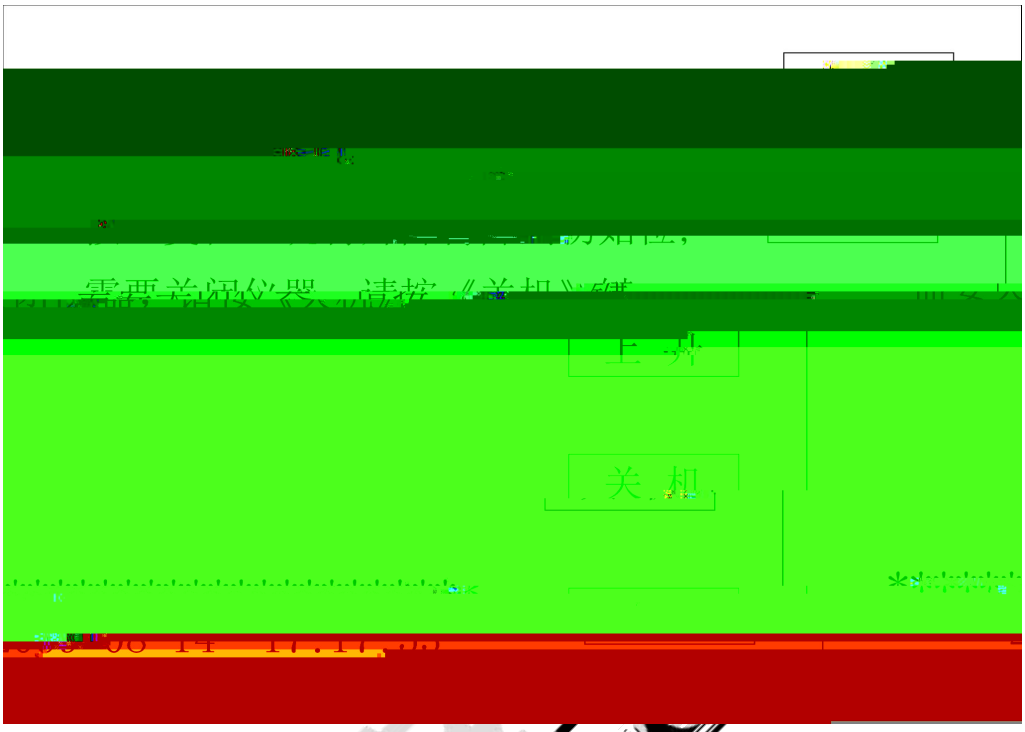

“ ”

“ ”
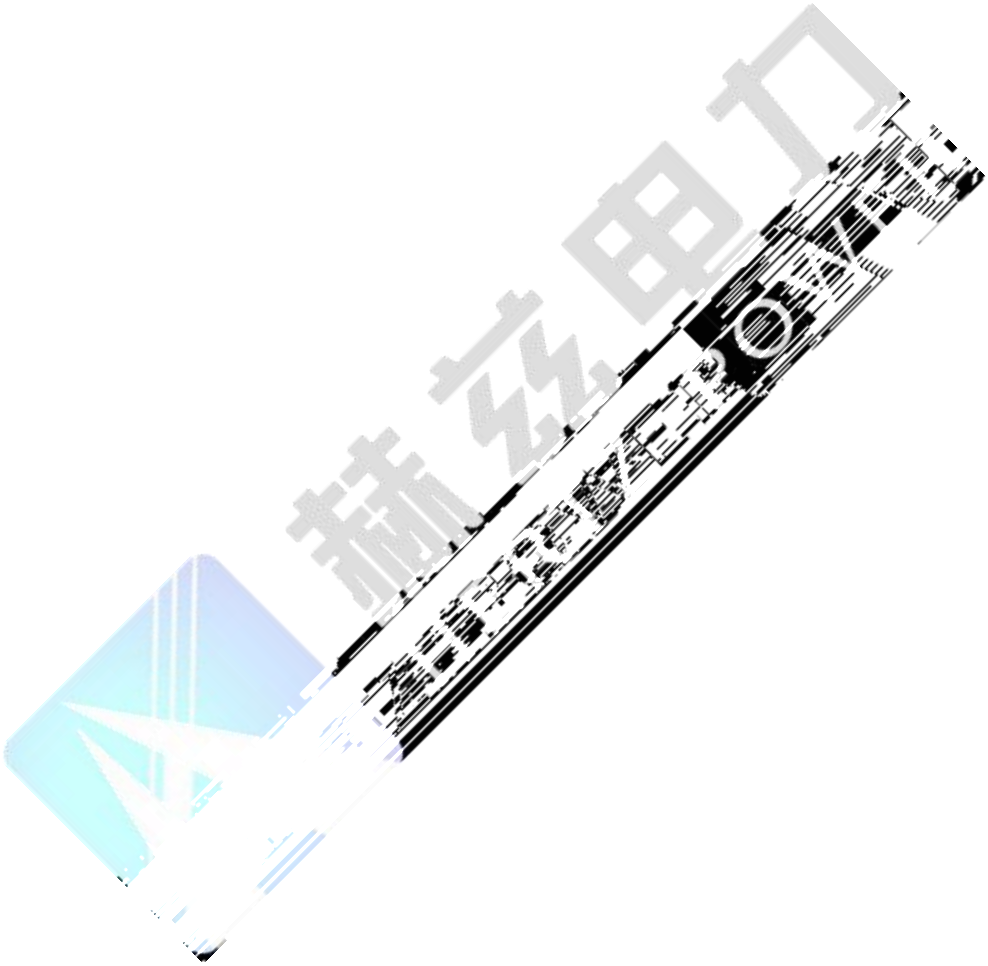
(—KOH)